

# レクビオ<sup>®</sup>皮下注 300mg シリンジ

## 投与方法資材の文言及び個装箱デザイン変更のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。持続型 LDL コレステロール低下 siRNA 製剤「レクビオ<sup>®</sup>皮下注 300mg シリンジ」（一般名：インクリラン ナトリウム）につきまして、投与方法資材の文言、及び個装箱デザインにつきまして、以下の通り変更いたしましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■ レクビオ<sup>®</sup>皮下注 300mg シリンジ投与方法資材の文言変更

レクビオ<sup>®</sup>皮下注 300mg シリンジの針づまりに伴う留意点について Step2,4 へ下記文言を追加記載しました。


- Step2: 注射の準備が整うまで、注射針カバーを外さないでください。注射針カバーを早く外してしまうと針の中の薬液が乾燥し、針詰まりを引き起こす可能性があります。
- Step4: 針の挿入後にプランジャーヘッドを押すことができない場合は、新しいプレフィルドシリンジを使用してください。

変更前	変更後
<p><b>2. 注射針カバーを外す</b></p> <p>注射針カバーをしっかりと持ってまっすぐに引っ張り、プレフィルドシリンジから外します。注射針の先に薬液の水滴が見えることがありますが、問題ありません。注射針カバーは再使用せず、廃棄してください。</p> 	<p><b>2. 注射針カバーを外す</b></p> <p>注射針カバーをしっかりと持ってまっすぐに引っ張り、プレフィルドシリンジから外します。注射針の先に薬液の水滴が見えることがありますが、問題ありません。注射針カバーは再使用せず、廃棄してください。</p> <p>注：注射の準備が整うまで、注射針カバーを外さないでください。注射針カバーを早く外してしまうと針の中の薬液が乾燥し、針詰まりを引き起こす可能性があります。</p> 
<p><b>4. 注入を開始する</b></p> <p>注射部位の皮膚をつまんだまま、ゆっくりとプランジャーヘッドを押しきり、全量を注入します。</p> 	<p><b>4. 注入を開始する</b></p> <p>注射部位の皮膚をつまんだまま、ゆっくりとプランジャーヘッドを押しきり、全量を注入します。</p> <p>注：針の挿入後にプランジャーヘッドを押すことができない場合は、新しいプレフィルドシリンジを使用してください。</p> 


## ■ レクビオ®皮下注 300mg シリンジ個装箱デザイン変更

レクビオ®皮下注 300mg シリンジにつきまして、より表記が見えやすくなるよう個包装デザインを変更いたしました。

- 変更点 1：他の側面と向きを揃えるため、側面の文字を 180 度回転




- 変更点 2：封緘テープとテキストが重なる可能性をなくすため、側面の製品名と使用期限/製造番号の記載を変動情報印字エリアの下へ移動し、GTIN の印字削除

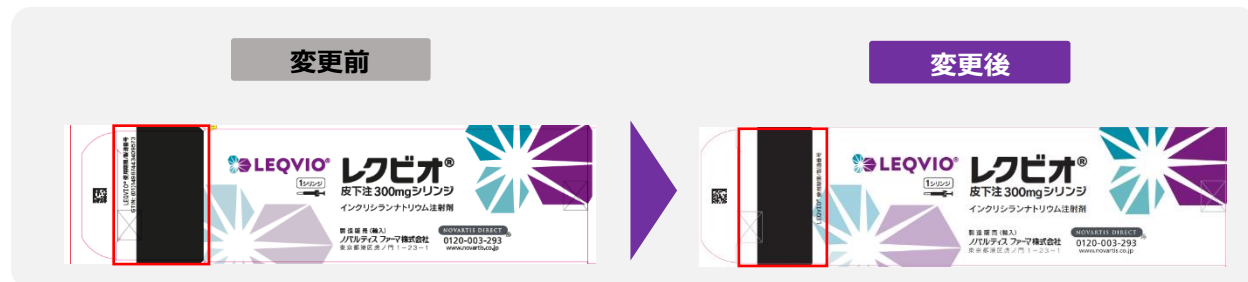

製品名	包装	各種コード等	
レクビオ®皮下注 300mg シリンジ	1 シリンジ	統一商品コード	443-40957-6
		変更品の初回製造番号	NT0533
		使用期限	2026 年 5 月
		出荷予定時期	2024 年 5 月下旬

\* 順次、出荷予定のため、実際の医薬機関への納品時期は在庫状況等により異なります。

**Dr's NET はこちら**  
レクビオの基本情報



以上

製造販売(輸入) (文献請求先及び問い合わせ先)  
**ノバルティス ファーマ株式会社**  
 東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ノバルティス ダイレクト 販売情報提供活動に関するご意見  
 TEL: 0120-003-293 TEL: 0120-907-026  
 受付時間: 月~金 9:00~17:30 (祝日及び当社休日を除く)

LEQ00007AA0003

2024 年 4 月作成