

長時間作用性吸入気管支拡張剤

オンブレス® 吸入用カプセル 150µg

ノータイス(包装同梱の患者指導箋)のデザイン等変更のお知らせ

謹啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「オンブレス®吸入用カプセル」ならびに吸入器「ブリーズヘラー®」に関しまして、利便性の向上、患者様の誤飲防止を目的にノータイスのデザイン等を変更いたしました。また、「オンブレス®吸入用カプセル」につきまして、販売包装単位のGS1コードに変動情報(使用期限、製造番号)を追加表示いたしますので、ご案内申し上げます。

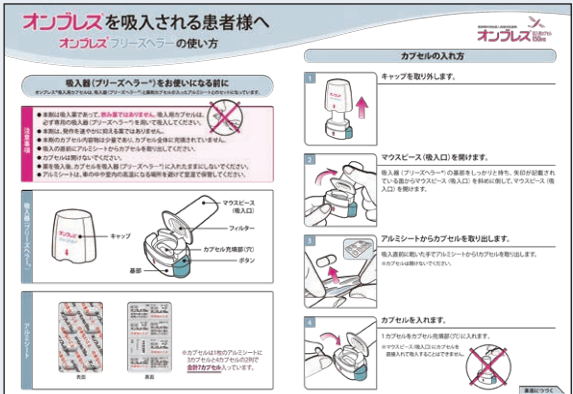
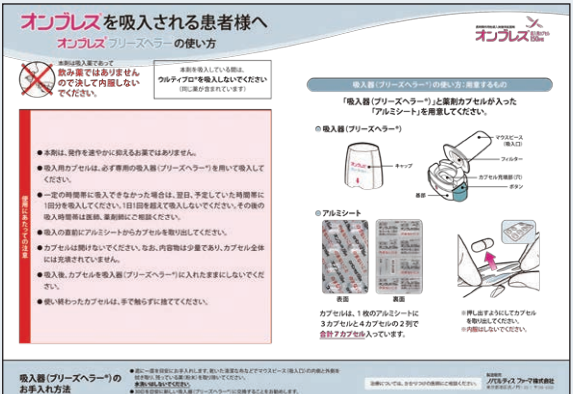
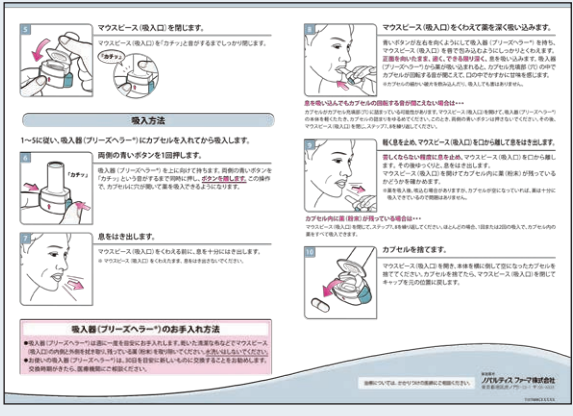
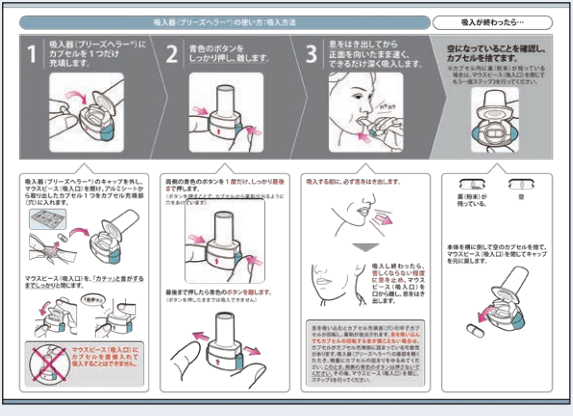
謹白

識別方法

包装には「包装変更品」、段ボール箱のラベルには「変更品」と表示いたします。

ノータイス変更内容

- 患者様の誤飲防止となるよう、注意喚起の文面を冒頭に配置しました。
- ブリーズヘラー®を正しくお使いいただくため、吸入方法の記載を注意点をやさしく分かりやすい4ステップにまとめました。

変更前のノータイス	変更後のノータイス
<p style="text-align: center;"><b>表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>オンブレスを吸入される患者様へ</b> オンブレス ブリーズヘラーの使い方</p> 	<p style="text-align: center;"><b>表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>オンブレスを吸入される患者様へ</b> オンブレス ブリーズヘラーの使い方</p> 
<p style="text-align: center;"><b>裏</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>裏</b></p> 

長時間作用性吸入気管支拡張剤

# オンブレス<sup>®</sup>吸入用カプセル 150 $\mu$ g

## ■個装変更内容

- 患者様の誤飲防止のため、薬剤師の皆様へのご要望を個装フタの裏側に記載しました。

**[薬剤師の皆様へ]**  
ブリーズヘラー<sup>®</sup>は外用薬の薬袋にカプセルと一緒にに入れてお渡してください。

※ブリーズヘラー<sup>®</sup>とカプセルを同じ薬袋で調剤しないと、カプセルが内服薬と紛れて誤って服用してしまう場合があります



## ■GS1コード変更内容

- 変動情報(使用期限、製造番号)を追加表示しました。

変更前	変更後
<p>(01)14987443000000</p>	<p>(17) (10) (01)14987443000000</p>

## ■変更品の製造番号・出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品の製造番号	出荷予定日
オンブレス <sup>®</sup> 吸入用カプセル 150 $\mu$ g	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー <sup>®</sup> 1個)	443-34399-3	P0013	2019年12月上旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、ブリーズヘラー <sup>®</sup> 1個)	443-34402-0	P0013	2019年11月下旬
	28カプセル (7カプセル×4シート)	443-34403-7	P0013	2019年12月下旬

※在庫状況により、変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、その折は何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。

製造販売 (文献請求先及び問い合わせ先)  
**ノバルティス ファーマ株式会社**  
東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ノバルティスダイレクト 販売情報提供活動に関するご意見  
TEL: 0120-003-293 TEL: 0120-907-026  
受付時間: 月~金 9:00~17:30 (祝祭日及び当社休日を除く)