

医療関係者各位

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ウルティプロ[®]吸入用カプセル

アルミシート仕様等変更のお知らせ

謹 啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「ウルティプロ[®]吸入用カプセル」に関しまして、利便性の向上を目的にアルミシートの仕様等を変更しましたのでご案内申し上げます。

謹 白

2018年8月

識別方法

○個装には「包装変更品」、段ボール箱のラベルには「変更品」と表示致します。
 なお、当面の間、右の患者様向けお知らせカード20枚/束を個装箱に封入致します。


—患者さまへ—

このたび、PTPシートのデザインが変更になりました。お薬はこれまでと変わりありません。

シートデザインベンコウ 7413713-A 33396

■変更内容

- アルミシートの両端をVノッチ(切込み)加工しました。
- アルミシートを従来品より広く剥がせるように接着の仕様を変更しました。

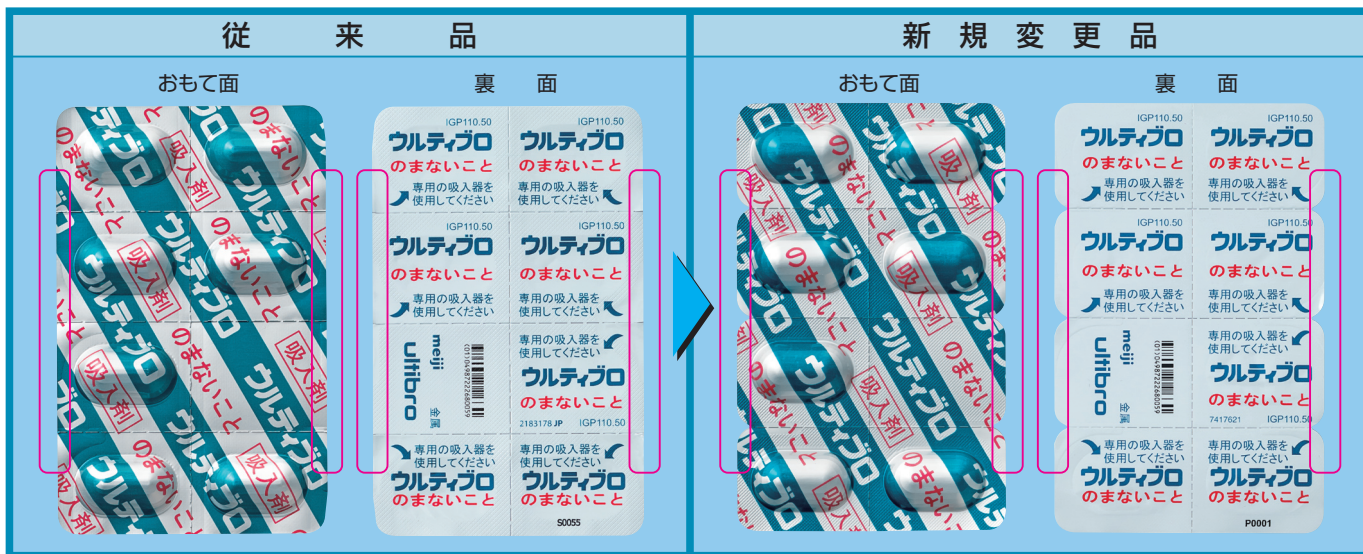

※個装箱に封入しております患者様用説明書につきましても、アルミシートの図を変更しております。

■変更品の製造番号・出荷予定時期

品 名	包 装	統一商品コード	変更品の製造番号	出荷予定時期
ウルティプロ [®] 吸入用カプセル	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー1個)	222-67916-9	P0011から	2018年10月中旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、ブリーズヘラー1個)	222-67924-4	P0004から	2018年 6 月下旬
	28カプセル (7カプセル×4シート)	222-67936-7	P0007 Aから	2018年 9 月下旬

※在庫状況により、変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、その折は何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。

UL00168AA0001 UL003201[®]
 [2018年5月作成] (SC)05M-19Y

製造販売

ノバルティス ファルマ株式会社
 東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

NOVARTIS DIRECT
 0120-003-293
 受付時間：月～金 9:00～17:30
 (祝祭日及び当社休日を除く)
 www.novartis.co.jp

販 売

Meiji Seika ファルマ株式会社
 東京都中央区京橋 2 - 4 - 16
<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>

〈資料請求先〉
 Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
 〒104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16
 フリーダイヤル(0120)093-396
 電話(03)3273-3539、FAX(03)3272-2438
 受付時間:9時～17時(土・日・祝日及び当社休業日を除く)