

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ウルティプロ[®] 吸入用カプセル

ノータイス(包装同梱の患者指導箋)のデザイン等変更のお知らせ

謹啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「ウルティプロ[®]吸入用カプセル」ならびに吸入器「ブリーズヘラー[®]」に関しまして、利便性の向上、患者様の誤飲防止を目的にノータイスのデザイン等を変更いたしました。また、「ウルティプロ[®]吸入用カプセル」につきまして、販売包装単位のGS1コードに変動情報(使用期限、製造番号)を追加表示いたしますので、ご案内申し上げます。

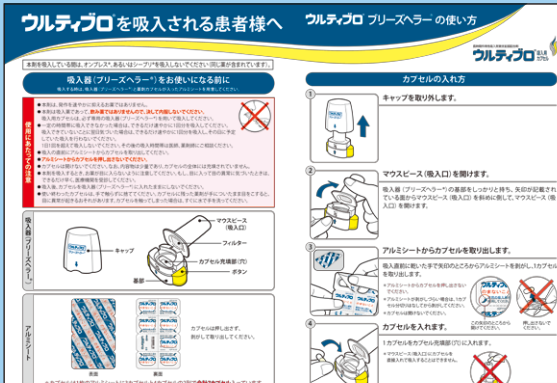
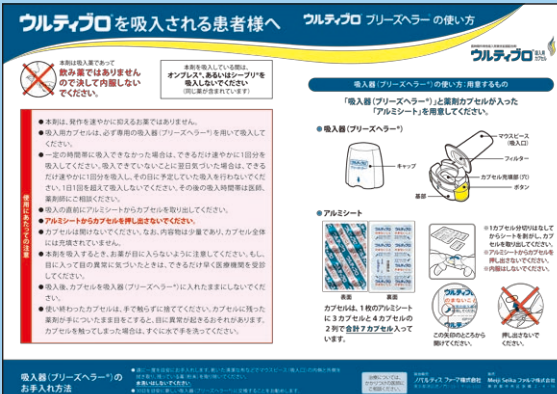

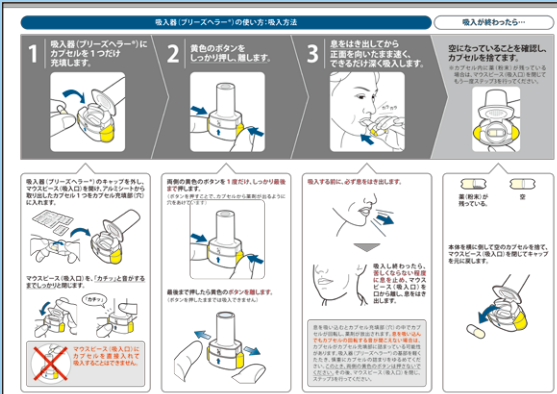
謹白

識別方法

包装には「包装変更品」、段ボール箱のラベルには「変更品」と表示いたします。

ノータイス変更内容

- 患者様の誤飲防止となるよう、注意喚起の文面を冒頭に配置しました。
- ブリーズヘラー[®]を正しくお使いいただくため、吸入方法の記載を注意点をやさしく分かりやすい4ステップにまとめました。

変更前のノータイス	変更後のノータイス
<p style="text-align: center;">表</p> 	<p style="text-align: center;">表</p> 
<p style="text-align: center;">裏</p> 	<p style="text-align: center;">裏</p> 

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ウルティbro[®] 吸入用 カプセル

■ 個装変更内容

- 患者様の誤飲防止のため、薬剤師の皆様へのご要望を個装フタの裏側に記載しました。

[薬剤師の皆様へ]

ブリーズヘラー[®]は外用薬の薬袋にカプセルと一緒にに入れてお渡してください。

※ブリーズヘラー[®]とカプセルを同じ薬袋で調剤しないと、カプセルが内服薬と紛れて誤って服用してしまう場合があります



■ GS1コード変更内容

- 変動情報(使用期限、製造番号)を追加表示しました。

変更前	変更後
<p>(01)14987222</p>	<p>使用期限 (17) 製造番号 (10)</p> <p>(01)14987222</p>

■ 変更品の製造番号・出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品の製造番号	出荷予定日
ウルティbro[®] 吸入用 カプセル	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー [®] 1個)	222-67916-9	P0032	2019年11月下旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、ブリーズヘラー [®] 1個)	222-67924-4	P0031	2019年11月中旬
	28カプセル (7カプセル×4シート)	222-67936-7	P0031	2019年11月下旬

※在庫状況により、変更品がお手元に届く時期が若干前後する場合がありますが、その折は何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。

製造販売 (文献請求先及び問い合わせ先)
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ノバルティス ダイレクト 販売情報提供活動に関するご意見
TEL: 0120-003-293 TEL: 0120-907-026
受付時間: 月～金 9:00～17:30 (祝祭日及び当社休日を除く)

販売
Meiji Seika ファルマ株式会社
東京都中央区京橋 2-4-16
<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>

(文献請求先及び問い合わせ先)
Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
〒104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16
フリーダイヤル(0120)093-396
電話(03)3273-3539、FAX(03)3272-2438

ULT00172AA0002 UL005402S
[2019年12月作成] (HA)12M-20Y